



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

มีการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

HS4 5-9.2

แผนการดูรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์



การบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์

ระบบก๊าซทางการแพทย์

ประเภทของก๊าซทางการแพทย์สามารถแบ่งได้ตามความเป็นอันตราย (categories of medical gases and their associated hazard) ดังนี้

- ก๊าซถาวร (permanent gas) เป็นก๊าซที่เมื่อทำการบรรจุภายใต้ความดันที่อุณหภูมิปกติ มีสภาพเป็นของเหลวบางส่วน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นต้น
- ก๊าซเหลว (liquefiable gas) เป็นก๊าซที่เมื่อทำการบรรจุภายใต้ความดันที่อุณหภูมิปกติ มีสภาพเป็นของเหลวบางส่วน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นต้น
- ก๊าซเหลวที่มีเยือกแข็ง (cryogenic liquid) เป็นก๊าซที่อยู่ในภาวะบรรจุภายใต้ความดันซึ่งเย็นกว่าที่อุณหภูมิห้อง -150 องศาเซลเซียส จึงมีความเย็นอย่างมากทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อที่มีชีวิต ทำให้เกิดอาการเยือกแข็งได้ เช่น ออกซิเจนเหลว (liquid oxygen) ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) เป็นต้น

สำหรับการดูแลรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์จำเป็นต้องมีผู้ที่ผ่านการอบรมมาในการที่จะดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ระบบก๊าซทางการแพทย์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
2. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
3. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
4. เพื่อให้ทราบปริมาณที่ใช้ไปจนพร้อมทั้งรักษาระบบทางการแพทย์ในขณะนั้น

สถานีจ่ายก๊าซออกซิเจน

โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ข้อมูลบริษัท

- ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537
- ก่อตั้งเขตเป็น 30 ล้าน
- ผลิตและจำหน่าย ก๊าซทางการแพทย์
- Tel. 054-260-444
- Fax. 054-327-860
- mail@standardgas.co.th

- โรงพยาบาลทองแสนขัน สาขาบ้านหมอเขย
- โทร. 054-840-522
- โทรสาร. 054-840-443
- ศูนย์กระจายสินค้า (เชียงใหม่)
- โทร. 053-694-4423

แฟ้มจัดเก็บ

ในการบันทึกการซ่อมบำรุง
ระบบก๊าซทางการแพทย์

โรงพยาบาลทองแสนขัน

ตารางตรวจเช็คระบบก๊าซทางการแพทย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันตรวจ	ชนิดก๊าซ	ชนิดถัง	ความดัน	หน่วย	พิกัด	หมายเหตุ
1 พ.ย. 65	300	50	✓	✓		
2 พ.ย. 65	200	50	✓	✓		
3 พ.ย. 65	800	50	✓	✓		
4 พ.ย. 65	200	49	✓	✓	สมบูรณ์	
5 พ.ย. 65	1000	49	✓	✓		
6 พ.ย. 65	150	43	✓	✓		
7 พ.ย. 65	160	43	✓	✓		
8 พ.ย. 65	160	20	✓	✓		
9 พ.ย. 65	160	40	✓	✓		
10 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
11 พ.ย. 65	120	40	✓	✓	ไม่พบ	
12 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
13 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
14 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
15 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
16 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
17 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
18 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
19 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
20 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
21 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
22 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
23 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
24 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
25 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
26 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
27 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
28 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
29 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		
30 พ.ย. 65	120	40	✓	✓		






ความปลอดภัย



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

มีการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

HS4 5-9.2

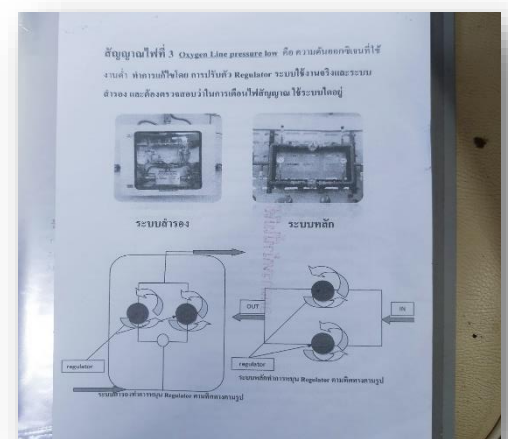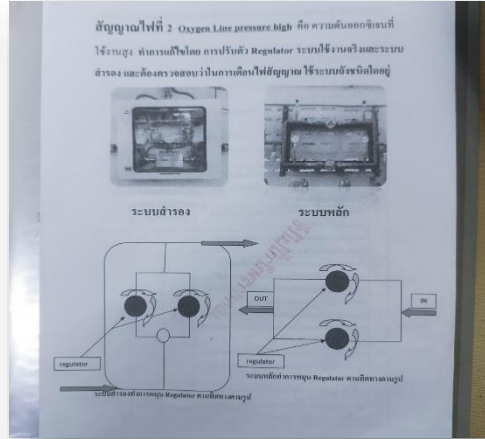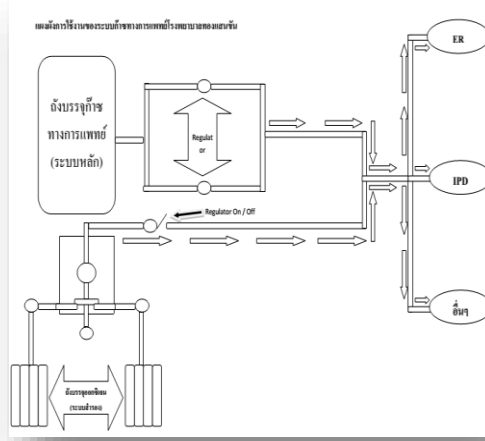

ความปลอดภัย